

# 人促血管生成素 1 酶联免疫吸附测定试剂盒

产品编号: MA0788 规格: 96 次

## 产品内容

产品组成	体积/数量
人 Ang-1 预包被板	8 孔条×12 个
样品稀释液	30mL
重组人 Ang-1 标准品(冻干)	2 支(10ng/支)
生物素标记人 Ang-1 抗体	130 μL(效价 1:100)
抗体稀释液	12mL
酶复合物(HRP 标记的链霉亲和素)	130 μL(效价 1:100)
酶复合物稀释液	12mL
浓缩洗涤液(25×)	30mL
显色剂 TMB	10mL
终止液	10mL
封板胶纸	4 张

## 产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法，用于检测样品中人Ang-1的浓度。人Ang-1捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的人Ang-1会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的人Ang-1抗体后，抗人Ang-1抗体与人Ang-1接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的HRP就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在人Ang-1，则会形成免疫复合物，其上连接的HRP会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取450nm处的OD值，人Ang-1浓度与OD450值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中OD值，即可计算出样品中人Ang-1的浓度。

促血管生成素1(Angiopoietin-1或Ang-1)隶属于促血管生成素家族，这个家族的蛋白主要包括促血管生成素1、促血管生成素2、促血管生成素3和促血管生成素4。人促血管生成素1是一个由498个氨基酸构成的分泌糖蛋白，其最显著的结构特征是：用于介导多聚体形成的N末端双卷曲结构域，以及用于与受体结合的C端的纤维蛋白酶结构域。

促血管生成素1在成人组织中广泛存在，特别在血管内皮的支持细胞如巨核细胞及血小板等表达较多，其主要功能是作为血管生成、重构及成熟的正相调节蛋白。促血管生成素1与促血管生成素2均可与受体酪氨酸激酶Tie-2结合，促血管生成素1与Tie-2结合从而激活下游PI3K、FAK等蛋白，进而调节产生纤溶酶和MMP-2等。Ang-1/Tie-2通路能维持造血干细胞在骨髓中处于静息状态，延迟分化。促血管生成素1和促血管生成素2水平的变化可以提示肿瘤血管的生成，有研究表明，循环的促血管生成素1水平的升高与高血压及肿瘤生成有关。



## 产品参数:

检测范围	0.156ng/mL~10ng/mL
敏感性	12pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

## 使用方法

### (一) 样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法:

(1) 细胞上清: 将细胞培养上清液100~500×g离心5min, 去除悬浮物后即可。

(2) 血清样品: 将全血在室温下静置0.5~2h, 待其自然凝固并析出血清后, 离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血清需置于冰上待用, 请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂;

(3) 血浆样品: 使用EDTA对全血进行抗凝处理后, 混合均匀置于冰上, 离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血浆需置于冰上待用;

(4) 组织匀浆/体液: 离心去除沉淀即可。

**注意:**

- ①若待测样品无法及时检测, 样品制备完成后, 请分装冻存于-20℃, 避免反复冻融;
- ②请保证待测样品清澈透明, 检测前如发现样品中有悬浮物, 需通过离心去除;
- ③为了保证检测结果准确, 请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

### 2. 稀释样本

查阅相关文献, 预估样品中待测因子的含量, 从而确定适当的稀释倍数, 使稀释后样品中待测因子的浓度处于ELISA试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同, 分别采取不同的稀释方案:

(1) 待测因子含量在100~1000ng/mL范围内, 一般按1:100稀释, 即向297μL样品稀释液中加入3μL样品。

(2) 待测因子含量在10~100ng/mL范围内, 一般按1:10稀释, 即向225μL样品稀释液中加入25μL样品。

(3) 待测因子含量在0.156~10ng/mL范围内, 一般按1:2稀释, 即向100μL样品稀释液中加入100μL样品。

(4) 待测因子含量≤0.156ng/mL, 样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考, 实验中请详细记录样品的稀释方法。

### (二) 检测准备工作

3. 试剂盒自4℃冰箱取出后, 请置于室温平衡20min; 如从-20℃取出, 各组分需彻底融化后再平衡20min; 检测完成后, 剩余试剂请及时置于4℃或-20℃保存。



4.将浓缩洗涤液(25×)用双蒸水或去离子水稀释成1×洗涤液。

5.重组人Ang-1标准品的稀释和使用(在使用前2h内准备, 室温操作, 请严格控制在25~28℃)

(1) 配制10ng/mL标准品: 取1mL样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置15min以上, 然后反复颠倒/搓动以助溶解;

(2) 按下表将10ng/mL标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀。(最高浓度为10ng/mL, 将标准品稀释液作为浓度0ng/mL。)

管号	稀释液用量(μL)	复溶后标准品用量(μL)	标准品的最终浓度(ng/mL)
A	0	1000	10
B	300	300(从A管取出)	5
C	300	300(从B管取出)	2.5
D	300	300(从C管取出)	1.25
E	300	300(从D管取出)	0.625
F	300	300(从E管取出)	0.312
G	300	300(从F管取出)	0.156
H	300	0	0

**注意:** 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6.准备生物素标记人Ang-1抗体工作液

(1) 按每孔需添加100μL抗体工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制100~200μL);

(2) 按1μL生物素标记人Ang-1抗体添加99μL抗体稀释液的比例配制工作液, 轻轻混匀。

7.准备酶复合物工作液(需在使用前1h内准备)

(1) 按每孔需添加100μL酶复合物工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制100~200μL);

(2) 按1μL酶复合物添加99μL酶复合物稀释液的比例配制工作液, 轻轻混匀。

### (三) 检测流程

8.通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于4℃或-20℃。

**注意:**

①标准品和样品建议做双复孔检测;

②每次实验均需绘制标准曲线。

9.将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100μL/孔)分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37℃孵育90min。

**注意:**

①请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;

②整个加样过程不宜超过10min, 否则可能会影响检测结果。

10.甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干。

11.加入稀释后的生物素标记人Ang-1抗体工作液(100μL/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37℃孵育60min。



12.洗板5次，每孔1×洗涤液用量为300μL，注入与吸出间隔15~30s，洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干。

**注意：**洗涤过程至关重要，洗涤不充分会导致结果产生较大误差。

13.加入稀释后的酶复合物(100μL/孔)，用封板胶纸封住反应孔，37℃避光孵育30min。

14.洗板5次，方法同步骤12；

15.加入显色剂TMB(100μL/孔)，用封板胶纸封住反应孔，避光37℃反应10~25min。注意：

- ①在保存和使用时，请勿将TMB接触氧化剂和金属；
- ②因实验室条件差异，最佳显色时间会有所不同，反应充分时肉眼可见标准品的前3~4孔有明显的梯度蓝色。

16.加入终止液(100μL/孔)，混匀后即刻使用酶标仪测量OD450，同时设定540nm或570nm作为校正波长，即可计算得到校正吸光度值(OD450-OD540或OD450-OD570)；

**注意：**读取OD值建议在10min内完成。

#### (四) 数据分析

17.绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，利用计算机软件作四参数逻辑(4-PL)曲线拟合创建标准曲线，通过样品的OD值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。


**注意：**

- ①复孔OD值在20%的差异范围内结果才有效，复孔OD值取平均后可作为测量值；
- ②若样品OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

#### 标准曲线范例

人Ang-1参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 ng/mL	0.096
0.156 ng/mL	0.166
0.312 ng/mL	0.246
0.625 ng/mL	0.410
1.25 ng/mL	0.719
2.5 ng/mL	1.212
5 ng/mL	1.822
10 ng/mL	2.380

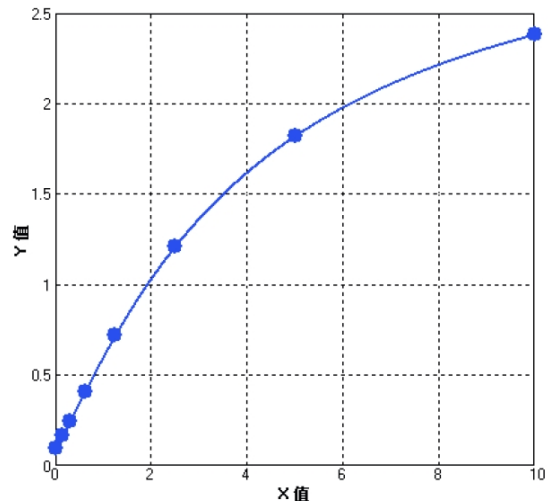

**注意：**本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

#### 保存条件



2~8℃保存，自生产之日起6个月有效；长期储存请置于-20℃，自生产之日起12个月有效。

## 注意事项

1. 浓缩洗涤液低温情况下可能会出现结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液；
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分；
3. 加样过程请避免产生气泡，实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀，否则会使结果产生较大误差；
4. 说明书中提到的室温条件，请严格控制在25~28℃；
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
6. 本产品仅限科研使用。

J240101

